ONETOUCH®

UltraEasy®

Système d'autosurveillance de la glycémie

GUIDE D'UTILISATION

AW 06637302A
Date de rév. : 10/2010

Contenu :

1 Vous familiariser avec votre lecteur 1

2 Régler la date et l'heure et coder votre lecteur 4

3 Contrôler votre glycémie 8

4 Revoir les résultats précédents 16

5 Réaliser un test avec la solution de contrôle 18

6 Entretien du système 20

7 Messages d'erreur et informations détaillées sur votre lecteur 24

Appelez le Service OneTouch® aux numéros suivants
Belgique : 0800/14660
Grand Duché de Luxembourg : 800 – 25749
ou
Visitez notre site à l'adresse www.OneTouch.be ou www.OneTouch.lu

S'il est impossible de contacter le Service OneTouch®, veuillez demander conseil à votre médecin traitant.

Fabriqué par :

LifeScan Europe
Division of Cilag GmbH
International
6300 Zug
Switzerland

LIFESCAN a Johnson & Johnson company

Distribué par :
LifeScan Benelux Division of Ortho-Clinical Diagnostics NV
Antwerpseweg 19-21 B-2340 Beerse Belgium

Johnson & Johnson
Medical Products GmbH
LifeScan Division
Gunoldstr. 16
A-1190 Wien

CE 0344

© 2009 LifeScan, Inc.

Avant de commencer
Avant d'utiliser ce produit pour tester la glycémie, lire attentivement ce guide d'utilisation ainsi que les notices accompagnant les bandelettes réactives et la solution de contrôle OneTouch® Ultra®. Faites attention aux mises en garde et avertissements figurant dans le présent manuel et identifiés par le symbole ⚠. Avant de tester la glycémie pour la première fois, il peut être utile de se familiariser avec le test à l'aide de la solution de contrôle. Voir paragraphe 5, Test avec solution de contrôle.

Utilisation prévue
Le système d'autosurveillance de glycémie OneTouch® UltraEasy® est conçu pour la mesure quantitative du glucose (sucre) contenu dans le sang capillaire total frais. Le système OneTouch® UltraEasy® doit être utilisé en usage externe en auto-test et à domicile (diagnostic *in vitro* uniquement), par des personnes atteintes de diabète, ou par des professionnels de santé dans un environnement médical, en tant qu'élément de surveillance de l'efficacité d'un traitement contre le diabète. Il ne convient pas au diagnostic du diabète ou aux tests sur le nouveau-né.

Principe du test
Le glucose contenu dans l'échantillon sanguin est mélangé aux composants chimiques spécifiques de la bandelette réactive afin de produire un petit courant électrique, car son intensité varie selon la quantité de glucose présente dans l'échantillon sanguin. Le lecteur mesure l'intensité du courant, calcule la glycémie, affiche le résultat et le conserve en mémoire.

1 Vous familiariser avec votre lecteur

Le système d'autosurveillance de la glycémie OneTouch® UltraEasy®

Inclus dans le kit :

a. Lecteur OneTouch® UltraEasy® (pile fournie)
b. Stylo autopiqueur
c. Sterile Lancette(s)
d. Étui de transport
e. Bandelettes réactives OneTouch® Ultra®

Si l'un de ces éléments est absent de votre kit, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800 - 25749 (Luxembourg).

Disponible séparément :
f. Solution de contrôle OneTouch® Ultra®
g. Embout transparent pour test AST

Pour obtenir la solution de contrôle, contactez le numéro vert OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg), ou adressez-vous à l'endroit où vos bandelettes vous ont été délivrées.

⚠ MISE EN GARDE : conserver le lecteur et les éléments nécessaires au test hors de portée des jeunes enfants. Les petits objets, tels que le couvercle du compartiment de pile, la pile, les bandelettes réactives, les lancettes et leur disque protecteur, ainsi que le capuchon du flacon de bandelettes réactives, peuvent être dangereux.

Vous familiariser avec votre lecteur

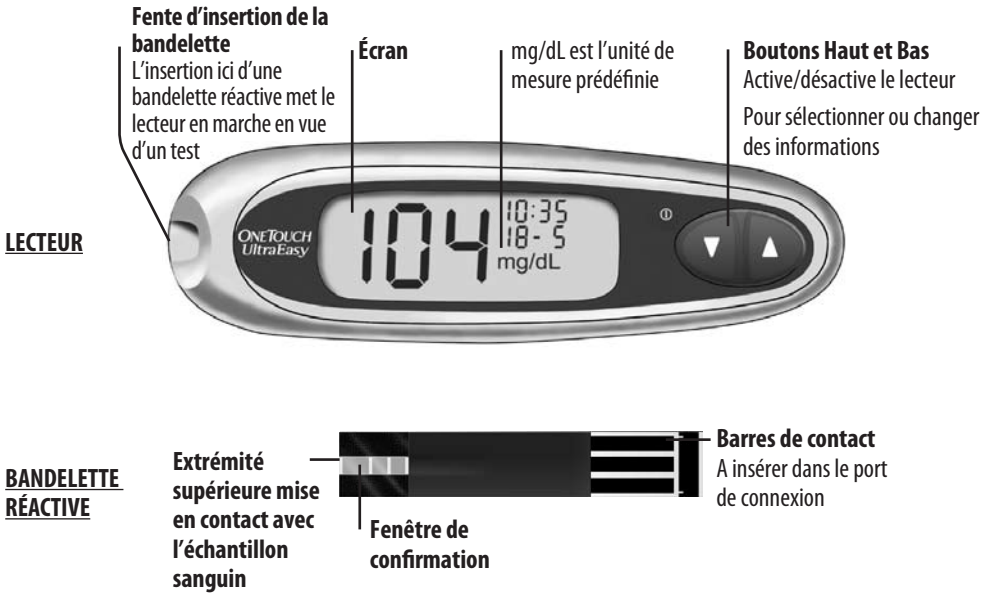

Mise en marche du lecteur

Pour effectuer un test, insérer une bandelette réactive jusqu'en bout de course. L'écran du lecteur s'allume et le lecteur effectue un bref contrôle du système. ***Ou***, pour changer la date et l'heure, commencez par éteindre le lecteur, puis appuyez sur ▼ et maintenez la touche enfoncée durant cinq secondes jusqu'à l'apparition de l'écran de démarrage. Après l'apparition de l'écran de contrôle de démarrage, la date et l'heure prédéfinies s'affichent à l'écran. ***Ou***, si vous souhaitez allumer votre lecteur pour revoir les résultats antérieurs, commencez par éteindre le lecteur, puis appuyez sur ▼ et relâchez.

Écran de démarrage

Chaque fois que vous mettez le lecteur en marche, un écran de contrôle de démarrage apparaît pendant deux secondes. Tous les segments d'affichage doivent apparaître brièvement sur cet écran, ce qui confirme que le lecteur fonctionne correctement. Pour vérifier que tous les segments de l'écran fonctionnent, dès l'apparition de l'écran de démarrage, appuyez sur ▲ et maintenez la touche enfoncée pour que cet écran reste affiché. Relâchez la touche ▲ pour passer à l'étape suivante. Si le lecteur ne se met pas en marche, commencez par remplacer la pile. Voir *Remplacement de la pile* au paragraphe 6.

Éteindre le lecteur

Il existe plusieurs façons d'éteindre le lecteur :

- Lorsque vous revoyez les résultats antérieurs, appuyez sur ▼ et maintenez la touche enfoncée durant deux secondes.
- Le lecteur de glycémie s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant deux minutes.
- Avant ou après avoir effectué un test, retirez la bandelette réactive.

⚠ **ATTENTION :** si une information quelconque n'apparaît pas sur l'écran de démarrage, cela peut signifier un problème au niveau du lecteur. Appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).

2 Régler la date et l'heure et coder votre lecteur

Réglage de la date et de l'heure

Votre lecteur OneTouch® UltraEasy® est fourni avec l'heure, la date et l'unité de mesure préalablement programmées. Avant d'utiliser le lecteur pour la première fois ou après avoir remplacé sa pile, vous devez contrôler et actualiser la date et l'heure. Veillez à effectuer les étapes 1 à 6 ci-dessous dans leur intégralité afin d'assurer que les réglages que vous souhaitez programmer sont sauvegardés.

⚠ MISE EN GARDE : si l'affichage indique mmol/L au lieu de mg/dL, contactez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg). L'utilisation d'une unité de mesure incorrecte peut conduire à une mauvaise interprétation du taux de glucose et donc amener à suivre un traitement inapproprié.

❶ Mettre le lecteur en marche

Appuyez sur ▼ et maintenez la touche enfoncée durant cinq secondes jusqu'à l'apparition de l'écran de contrôle de démarrage. Après l'apparition de l'écran de contrôle de démarrage, la date et l'heure prédéfinies s'affichent à l'écran durant cinq secondes. L'heure commence alors à clignoter.

REMARQUE : si un réglage n'a pas à être modifié, attendez simplement cinq secondes. L'écran du lecteur passe automatiquement au réglage suivant.

❷ Régler l'heure

Lorsque l'heure clignote sur l'écran, appuyez sur ▲ ou sur ▼ puis relâchez pour avancer ou reculer d'une heure. Pour aller plus vite, maintenez les touches ▲ or ▼ enfoncées.

Lorsque l'heure correcte apparaît sur l'écran, attendez cinq secondes. Votre saisie sera enregistrée et vous pourrez passer au réglage suivant. Les minutes commencent alors à clignoter.

❸ Régler les minutes

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour changer les minutes. Une fois les minutes corrigées à l'écran, attendez cinq secondes pour passer au réglage suivant. L'année (les deux derniers chiffres seulement), le mois et le jour apparaissent sur l'écran et l'année clignote.

❹ Régler l'année
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour changer l'année. Une fois l'année corrigée à l'écran, attendez cinq secondes pour passer au réglage suivant. Le mois commence alors à clignoter.

❺ Régler le mois
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour changer le mois. Une fois le mois corrigé à l'écran, attendez cinq secondes pour passer au réglage suivant. Le jour commence alors à clignoter.

❻ Régler le jour
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour changer le jour. Une fois le jour corrigé à l'écran, attendez cinq secondes pour passer à l'écran suivant.

Vos réglages de date et d'heure seront affichés durant cinq secondes. Après ces cinq secondes, les réglages seront enregistrés et le lecteur s'éteindra. Si vous souhaitez modifier vos réglages, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pendant que la date et l'heure sont affichées à l'écran. Le lecteur vous renverra au premier écran de réglage où vous pourrez commencer par l'heure.

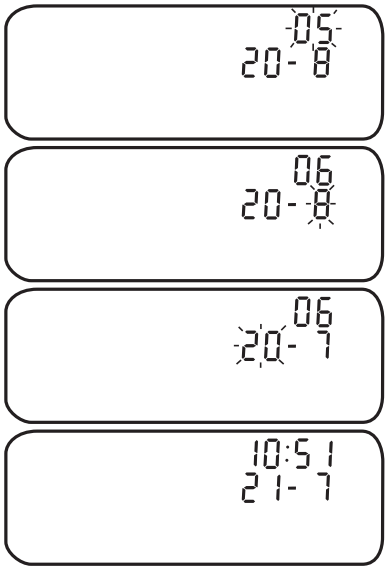

Coder votre lecteur

Pour effectuer un test de glycémie, vous devez avoir à portée de main :

- le lecteur OneTouch® UltraEasy® ;
- les bandelettes réactives OneTouch® Ultra® ;
- le stylo autopiqueur
- les lancettes stériles munies de leurs disques protecteurs
- la solution de contrôle OneTouch® Ultra®.

REMARQUE :

- Seules les bandelettes réactives OneTouch® Ultra® doivent être utilisées avec le lecteur de glycémie OneTouch® UltraEasy®.
- Avant de commencer le test, assurez-vous que le lecteur et les bandelettes réactives sont à température ambiante.
- Le test doit être effectué dans la plage de températures de fonctionnement (entre 6 et 44 °C). Pour obtenir des résultats précis, effectuer le test à une température aussi proche que possible de la température ambiante (20–25 °C)

⚠ **ATTENTION :** si vous ne pouvez pas effectuer le test en raison d'un problème avec les éléments nécessaires au test, contactez votre médecin traitant ou le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg). La non-réalisation du test peut retarder la prise de décisions liées au traitement et engendrer de graves problèmes de santé.

❶ Vérifier le code imprimé sur le flacon de bandelettes réactives avant d'insérer la bandelette réactive

Les numéros de code servent à étalonner le lecteur avec les bandelettes réactives que vous utilisez, afin de donner des résultats de test exacts. Vous devez coder le lecteur avant de l'utiliser pour la première fois, puis chaque fois qu'un nouveau flacon de bandelettes réactives est entamé.

⚠ **ATTENTION :** le flacon de bandelettes réactives contient des produits dessiccatifs qui sont dangereux s'ils sont inhalés ou ingérés et qui peuvent provoquer une irritation des yeux ou de la peau.

❷ Insérer une bandelette réactive pour mettre le lecteur de glycémie en marche

Commencer avec le lecteur de glycémie éteint. Si le lecteur a déjà été mis en marche pour modifier des réglages ou consulter des résultats antérieurs, il faut l'éteindre. Retirer une bandelette réactive du flacon. Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de toucher une quelconque partie de la bandelette réactive. Les bandelettes réactives ne doivent **en aucun cas** être pliées, coupées ou modifiées. Utiliser la bandelette réactive immédiatement après l'avoir sortie du flacon.

Tenez le lecteur comme indiqué et insérez la bandelette réactive dans la fente d'insertion. Les trois barres de contact doivent être orientées vers vous. Pousser la bandelette réactive dans la fente d'insertion jusqu'en bout de course. **Ne pliez pas** la bandelette.

⚠ **ATTENTION :** les bandelettes réactives OneTouch® Ultra® sont à usage unique. Ne jamais réutiliser une bandelette réactive sur laquelle du sang ou de la solution de contrôle aurait été appliqué(e).

Après l'écran de contrôle de démarrage, le lecteur de glycémie affiche le code correspondant au dernier test. Si un symbole « ⸢ » fixe et un symbole « — » clignotant s'affichent à la place d'un numéro de code, comme c'est le cas lors de la première utilisation du lecteur, suivre les instructions de l'étape 3 pour entrer un code.

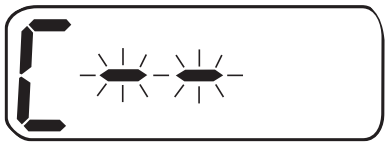

❸ Faire correspondre le code affiché à l'écran du lecteur de glycémie avec celui imprimé sur le flacon de bandelettes réactives

Si le code du lecteur ne correspond pas au code du flacon de bandelettes réactives, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour le faire correspondre au numéro de code du flacon de bandelettes réactives. Le nouveau numéro de code clignote à l'écran durant trois secondes puis reste fixe durant trois autres secondes.

L'affichage passe automatiquement à l'écran contenant l'icône d'application d'échantillon.

Si les codes correspondent, attendez trois secondes. L'affichage passe automatiquement à l'écran contenant l'icône d'application d'échantillon. Le lecteur est alors prêt pour exécuter un test de glycémie.

REMARQUE :

- Si l'écran contenant l'icône clignotante d'application d'échantillon apparaît avant d'avoir pu vous assurer que les codes correspondent, retirez la bandelette réactive, attendez que le lecteur s'éteigne puis recommencez depuis l'étape 1 de *Coder votre lecteur*.
- Si vous appuyez sur ▲ par erreur et que le symbole **CtL** de test avec la solution de contrôle apparaît à l'écran, appuyez de nouveau sur ▲ pour retourner à l'écran contenant l'icône clignotante d'application d'échantillon.

⚠ **ATTENTION :** afin d'obtenir des résultats précis, il est primordial de vérifier que le numéro de code affiché sur le lecteur correspond à celui qui est imprimé sur le flacon de bandelettes réactives. À chaque nouveau test, vérifier que les numéros de code correspondent.

3 Contrôler votre glycémie

Prélever un échantillon sanguin

Présentation du stylo autopiqueur

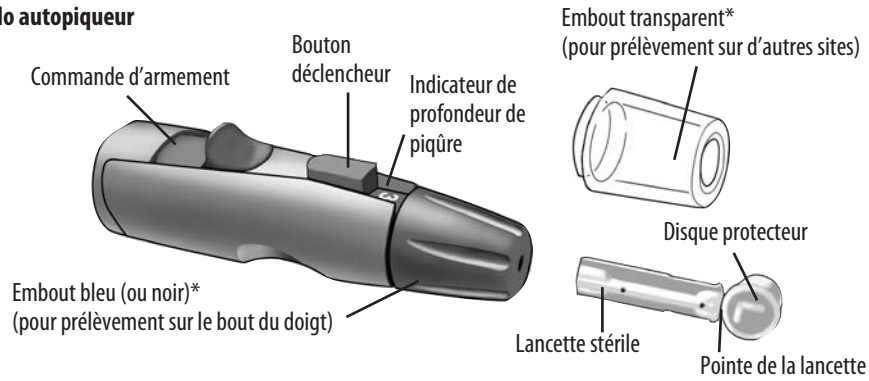

** L'embout bleu (ou noir) et l'embout transparent servent également au réglage de la profondeur.*

REMARQUE : si vous ne disposez pas d'un stylo autopiqueur, référez-vous aux instructions fournies avec votre stylo autopiqueur.

⚠ **ATTENTION :** pour réduire le risque d'infection :

- Veillez à bien nettoyer le site de prélèvement avec du savon et de l'eau avant d'effectuer le prélèvement.
- Ne partagez jamais une lancette ou un stylo autopiqueur avec qui que ce soit.
- Utilisez toujours une nouvelle lancette stérile ; les lancettes sont à usage unique.
- Maintenez votre lecteur et votre stylo autopiqueur propres. Voir *Entretien du système* au paragraphe 6.

Préparer le site de prélèvement
Avant de procéder à votre test sanguin, lavez-vous les mains et l'avant-bras (le cas échéant) avec de l'eau chaude et du savon. Rincez et séchez.

Piquer et prélever au bout du doigt
❶ Enlevez l'embout bleu (ou noir)

❷ Insérer une lancette stérile dans le stylo autopiqueur
Insérez la lancette dans le support en la poussant fermement. Dévissez le disque protecteur jusqu'à ce qu'il se détache de la lancette et le conserver pour une utilisation ultérieure. **Ne vissez pas** la lancette.



❸ Remettre l'embout bleu (ou noir) en place

❹ Ajuster le réglage de profondeur
Le stylo autopiqueur possède neuf réglages de profondeur de piqûre, numérotés de 1 à 9. Les numéros les plus petits correspondent à des piqûres superficielles, les plus grands à des piqûres plus profondes. Les piqûres superficielles conviennent aux enfants et à la plupart des adultes. Les piqûres plus profondes conviennent mieux aux personnes dont la peau est épaisse ou calleuse. Faites tourner l'embout bleu (ou noir) jusqu'à l'apparition du numéro correspondant au réglage voulu.

REMARQUE : une piqûre superficielle est moins douloureuse. Choisissez d'abord un réglage pour une piqûre superficielle, puis augmentez la profondeur jusqu'à un réglage vous permettant d'obtenir une goutte de sang suffisante pour réaliser le test (**taille approximative** ●).

❺ Armer le stylo autopiqueur
Ramenez le bouton d'armement jusqu'au déclic. Si aucun déclic ne se fait entendre, il est possible que le stylo autopiqueur ait été armé au moment de l'insertion de la lancette.

❻ Piquer le doigt
Maintenez fermement le stylo autopiqueur sur le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur. Retirez le stylo autopiqueur du doigt.

❼ Prélever une goutte de sang bien ronde
Pressez et/ou massez doucement le bout du doigt jusqu'à la formation d'une goutte de sang bien ronde **(taille approximative ●)**. Si le sang s'étale ou coule, **ne pas** utiliser l'échantillon. Essuyez le site et pressez doucement le doigt jusqu'à l'obtention d'une autre goutte de sang ou piquez à un autre endroit.

Choisir le bon site de prélèvement au bon moment

Le lecteur OneTouch® UltraEasy® permet de prélever un échantillon sanguin sur le bout du doigt, l'avant-bras ou la paume de la main. Un prélèvement sur l'avant-bras ou la paume de la main est aussi appelé « autre site de test » (AST). Dans certains cas, les résultats d'un prélèvement sur l'avant-bras ou la paume de la main peuvent différer de ceux obtenus par prélèvement sur le doigt. Avant d'effectuer des prélèvements sur l'avant-bras ou la paume, consultez votre médecin traitant.

Si vous procédez à un test :	**Utilisez un échantillon sanguin prélevé sur :**
Régulièrement avant les repas Avant ou plus de deux heures après : • un repas, • une injection d'insuline à action rapide ou un bolus de pompe à insuline, • un exercice physique.	Bout du doigt, avant-bras ou paume
Lorsque votre glycémie change rapidement, c'est-à-dire : • dans les deux heures qui suivent un repas, • dans les deux heures qui suivent une injection d'insuline à action rapide ou un bolus de pompe à insuline, ou • pendant ou dans les deux heures qui suivent un exercice physique. Lorsque vous craignez une éventuelle hypoglycémie (glycémie faible)	Bout du doigt

⚠ **ATTENTION : ne prélevez pas** d'échantillon sur votre avant-bras ou la paume de votre main lorsque :

- Vous pensez que votre glycémie diminue rapidement, c'est-à-dire dans les deux heures qui suivent un exercice physique ou une prise d'insuline à action rapide ou un bolus de pompe à insuline. Un test réalisé sur le doigt peut détecter une hypoglycémie ou une réaction à l'insuline plus rapidement qu'un test réalisé sur l'avant-bras ou la paume.
- Moins de deux heures se sont écoulées depuis un repas, une prise d'insuline à action rapide, un bolus de pompe à insuline ou un exercice physique, ou bien vous pensez que votre glycémie va changer rapidement.
- Vous craignez une éventuelle hypoglycémie ou une réaction à l'insuline, lorsque vous conduisez par exemple. Cela s'avère particulièrement important en cas d'hypoglycémie asymptomatique (absence de symptômes indiquant une réaction à l'insuline).

Important : consultez votre médecin traitant avant d'effectuer des prélèvements sur l'avant-bras ou la paume.

Changez de site de prélèvement pour chaque test. Des piqûres répétées au même endroit peuvent occasionner des douleurs et des callosités. En cas de contusion ou de difficulté de prélèvement, préférer un prélèvement sur le bout du doigt. Le choix du site de prélèvement devra éventuellement être revu avec le médecin traitant.

Piquer et prélever à partir d'un autre site de test

Les prélèvements pratiqués sur l'avant-bras ou la paume de la main permettent d'éviter des prélèvements trop fréquents sur le bout du doigt. Ils peuvent également être parfois moins douloureux. Le prélèvement d'un échantillon de sang sur l'avant-bras ou la paume diffère du prélèvement sur le bout du doigt.

Prélèvement sur l'avant-bras

Choisissez une zone souple et charnue de l'avant-bras, dépourvue de protubérance osseuse, de veines apparentes et de poils. L'écoulement sanguin est parfois plus faible au niveau de l'avant-bras qu'au niveau du bout du doigt. Pour obtenir une goutte de sang d'une taille suffisante, masser préalablement le site de prélèvement ou y appliquer de la chaleur afin de favoriser l'écoulement sanguin.

Avant-bras

Paume

Prélèvement sur la paume

Choisissez une zone charnue de la paume de la main, sous le pouce ou le petit doigt. Choisissez un point dans une zone dépourvue de veines apparentes ou de lignes profondes qui pourraient provoquer l'étalement de la goutte de sang.

L'embout transparent n'est utilisé que pour les prélèvements sur l'avant-bras et la paume. Remplacer l'embout bleu (ou noir) par l'embout transparent.

❶ Insérer une lancette stérile et mettre l'embout transparent en place

❷ Ajuster le réglage de profondeur

Pour obtenir une goutte de sang d'une taille suffisante sur l'avant-bras ou la paume, il est possible que vous deviez augmenter la profondeur du stylo autopiqueur. Pour augmenter la profondeur, faire tourner l'embout transparent vers les numéros les plus grands.

Veillez à bien armer le stylo autopiqueur.

❸ Piquer votre avant-bras ou votre paume

Appuyez fermement le stylo autopiqueur contre votre avant-bras ou votre paume pendant quelques secondes. **Attendez jusqu'à ce que la surface cutanée se trouvant en dessous de l'embout transparent change de couleur (du sang s'accumule sous la peau). Ceci indique que l'écoulement sanguin est suffisant pour obtenir un bon échantillon.** Appuyer ensuite sur le bouton déclencheur tout en maintenant la pression. Maintenir le stylo autopiqueur appuyé contre la peau jusqu'à la formation, sous l'embout, d'une goutte de sang bien ronde.

Avant-bras

Paume

Lors d'un prélèvement sur l'avant-bras ou la paume, s'assurer que la goutte de sang est suffisante **(taille approximative ●)** avant de relâcher la pression et de retirer le stylo autopiqueur.

❹ Retirer le stylo autopiqueur
Éloignez avec précaution le stylo autopiqueur de votre peau. **N'étalez pas** l'échantillon sanguin.

REMARQUE :
- Il est possible que vous deviez attendre un peu plus longtemps pour obtenir une goutte de sang de taille suffisante sur l'avant-bras ou la paume. **Ne pressez pas** le site de prélèvement de manière excessive.
- Si la goutte de sang coule ou s'étale au contact d'un poil ou d'une ligne de la main, **ne pas** l'utiliser comme échantillon. Tenter un nouveau prélèvement à un autre endroit.
- N'oubliez pas : pour obtenir une goutte de sang d'une taille suffisante, il peut être nécessaire d'augmenter la profondeur du stylo autopiqueur (**taille approximative ●**).

Appliquer l'échantillon sanguin et lire le résultat

Le lecteur est prêt à indiquer un résultat de glycémie lorsque le prélèvement est effectué et que s'affiche l'icône clignotante d'application d'échantillon. Si le lecteur n'affiche pas l'écran contenant l'icône clignotante d'application d'échantillon, retirer la bandelette réactive inutilisée et recommencer le processus de test. Voir *Prélever un échantillon sanguin* au paragraphe 3.

❶ Préparer l'application de l'échantillon sanguin
Tout en gardant votre doigt droit et immobile, approchez le lecteur et la bandelette réactive de la goutte de sang.

Bout du doigt

N'appliquez pas de sang sur la partie supérieure de la bandelette réactive.

Ne tenez pas le lecteur et la bandelette réactive en dessous de la goutte de sang. Le sang pourrait couler dans la fente d'insertion et endommager le lecteur.

Lorsque vous appliquez une goutte de sang prélevée sur l'avant-bras ou la paume, conservez votre avant-bras ou votre paume immobile et approchez le bord supérieur de la bandelette réactive de la goutte de sang avec l'autre main.

Avant-bras

Paume

❷ Appliquer l'échantillon de sang

Aligner la bandelette réactive avec la goutte de sang de sorte que le sillon étroit situé à l'extrémité de la bandelette réactive soit en contact avec la goutte de sang.





Sillon étroit



Mettre délicatement en contact le sillon avec la goutte de sang.

Veillez à ne pas appuyer la bandelette réactive contre le bout de votre doigt car elle pourrait alors ne pas être complètement remplie.

***REMARQUE* :**

- Prenez soin de **ne pas** étaler ni racler la goutte de sang avec la bandelette réactive.
- **Ne rajoutez pas** davantage de sang sur la bandelette réactive après un premier dépôt.
- **Ne faites pas bouger** la bandelette réactive dans le lecteur au cours du test.

⚠ **ATTENTION :** le message **Er 5** ou un résultat erroné s'affichent si l'échantillon sanguin ne remplit pas complètement la fenêtre de confirmation. Voir *Comprendre les messages d'erreur et les autres messages* au paragraphe 7. Jetez la bandelette et recommencez le processus.

❸ Attendre le remplissage complet de la fenêtre de confirmation

La goutte de sang est aspirée dans le sillon étroit et la fenêtre de confirmation doit être complètement remplie.

Lorsque la fenêtre de confirmation est remplie, cela signifie que vous avez appliqué assez de sang. Vous pouvez à présent éloigner la bandelette réactive de la goutte de sang et attendre que le lecteur effectue un compte à rebours de 5 à 1.



Fenêtre de confirmation

Remplie

Pas complètement remplie

❹ Lire le résultat sur le lecteur de glycémie

Votre glycémie s'affiche à l'écran, ainsi que l'unité de mesure, la date et l'heure du test. Les résultats de mesure de la glycémie sont automatiquement stockés dans la mémoire du lecteur.

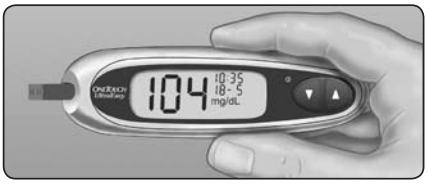

(Exemple)

⚠ **ATTENTION :** si le test est effectué à une température proche de la limite inférieure de la plage de fonctionnement (6 à 44°C) et que le taux de glucose est élevé (supérieur à 180 mg/dL), le résultat affiché sur le lecteur peut être inférieur au taux de glucose réel. Dans ce cas, renouvelez le test dans un endroit plus chaud avec une nouvelle bandelette réactive aussi rapidement que possible.

⚠ MISE EN GARDE : si mg/dL n'apparaît pas à côté du résultat du test, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg). L'utilisation d'une unité de mesure incorrecte peut conduire à une mauvaise interprétation du taux de glucose et donc amener à suivre un traitement inapproprié.

Messages d'erreur

Si l'écran affiche un message **Er** au lieu d'un résultat, consultez *Comprendre les messages d'erreur et les autres messages* au paragraphe 7.

Résultats de test inattendus

Si vos résultats de glycémie sont trop bas, trop élevés ou inattendus, référez-vous aux avertissements ⚠ ci-après.

⚠ ATTENTION : déshydratation et résultats faibles
Toute déshydratation sévère ou perte d'eau excessive peut fausser les résultats. Si vous soupçonnez une déshydratation sévère, consultez immédiatement votre médecin traitant.

⚠ ATTENTION : résultats de mesure de la glycémie faibles
Si le résultat de votre test est inférieur à 70 mg/dL ou indique LO (Faible), cela peut indiquer une hypoglycémie (faible concentration de glucose dans le sang). Dans ce cas, traitez immédiatement en suivant les recommandations du médecin traitant. Bien que ce résultat puisse être dû à une erreur de test, il est plus sûr de traiter d'abord, puis de refaire le test.

⚠ ATTENTION : résultats de mesure de la glycémie élevés
Si le résultat du test de glycémie est supérieur à 180 mg/dL, cela peut signifier une hyperglycémie (concentration élevée de glucose dans le sang). Si ce résultat ne paraît pas sûr, refaire le test. Le médecin traitant peut déterminer avec le patient d'éventuelles mesures à prendre si les résultats du test sont supérieurs à 180 mg/dL.

Si le lecteur indique HI (Elevé), il est probable que votre glycémie dépasse 600 mg/dL, ce qui est le signe d'une hyperglycémie importante. Controlez de nouveau votre taux de glycemie. Si le lecteur affiche de nouveau HI, cela peut indiquer un grave probleme de controle de la glycemie. Dans ce cas, il est important de contacter immediatement le medecin traitant et de suivre ses instructions.

⚠ ATTENTION : résultats de glycémie inattendus répétés
Si des résultats inattendus continuent d'être obtenus, contrôler le système avec la solution de contrôle. Voir paragraphe 5, Test avec solution de contrôle. Si les symptômes ne concordent pas avec les résultats de mesure de la glycémie et que toutes les instructions figurant dans le présent guide d'utilisation ont été suivies, consulter le médecin traitant. N'ignorez jamais les symptômes et n'opérez jamais de changement important dans votre programme de suivi du diabète sans en parler à votre médecin traitant.

⚠ ATTENTION : taux inhabituel de globules rouges
Un taux d'hématocrite (pourcentage de globules rouges dans le sang) très élevé (supérieur à 55 %) ou très bas (inférieur à 30 %) peut être la cause de résultats erronés.

Après l'obtention d'un résultat
Une fois que vous avez lu le résultat de votre test, vous pouvez :
- Revoir la mémoire du lecteur en appuyant sur ▼ pour entrer en mode mémoire, voir au paragraphe 4, Revoir les résultats antérieurs, *ou*
- Éteindre le lecteur en retirant la bandelette réactive.

Retrait de la lancette usagée
Tirez sur l'embout du stylo autopiqueur pour l'enlever. **Avant d'enlever la lancette, isoler la pointe exposée.** Placer le disque protecteur de la lancette sur une surface dure. Enfoncer la pointe de la lancette dans le disque. Enlever la lancette du stylo autopiqueur et la jeter dans un récipient spécial pour objets tranchants. Remettre l'embout en place.

Jeter la lancette et la bandelette réactive usagées
Il est important de jeter avec précaution la lancette usagée après chaque utilisation en vue d'éviter toute blessure involontaire due à l'aiguille de la lancette. Les bandelettes réactives et les lancettes usagées doivent être considérées comme des résidus biologiquement dangereux. Veillez à respecter les réglementations locales ou les recommandations de votre médecin pour les éliminer correctement.

4 Revoir les résultats précédents

Revoir les résultats précédents

Le lecteur enregistre un maximum de 500 résultats de test de glycémie. Lorsque la mémoire du lecteur est pleine, le résultat le plus ancien disparaît, au profit du plus récent. Lorsque vous effectuez un test, le résultat est enregistré automatiquement, ainsi que l'heure, la date et l'unité de mesure. Vous pouvez revoir les résultats enregistrés dans la mémoire du lecteur, à partir du plus récent.

Si le lecteur est éteint, appuyez sur le bouton ▼ et maintenez-le enfoncé pour mettre le lecteur en marche. Après l'apparition de l'écran de contrôle de démarrage, votre résultat le plus récent s'affiche à l'écran. La lettre « *M* » apparaît également pour indiquer le mode Mémoire.

Si vous venez de réaliser un test, laissez la bandelette dans le lecteur et appuyez sur ▼ pour accéder en mode mémoire. Le résultat de votre test de glycémie s'affiche sur l'écran du lecteur ainsi qu'un « *M* ».

Pour voir le résultat précédent enregistré sur le lecteur, appuyez sur ▼. Ensuite, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler tous vos résultats en avant ou en arrière. Lorsque vous avez fini de revoir vos résultats précédents, appuyez sur ▼ et maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes pour éteindre le lecteur.

REMARQUE : si aucun résultat n'est actuellement enregistré dans le lecteur, le symbole « — » s'affichera à l'écran.

Télécharger les résultats sur un ordinateur

Vous pouvez utiliser votre lecteur conjointement au logiciel de gestion du diabète DMS OneTouch® qui permet de stocker vos enregistrements et d'établir des modèles de planification de vos repas, de votre activité physique et de votre traitement. Le logiciel DMS OneTouch® présente les informations téléchargées depuis le lecteur de glycémie sous forme de tableaux et de graphiques. Si vous utilisez actuellement le logiciel DMS OneTouch®, des mises à jour de logiciel peuvent être nécessaires pour l'utiliser avec un lecteur OneTouch® UltraEasy®. Veuillez visiter notre site à l'adresse suivante : www.OneTouch.be ou www.OneTouch.lu.

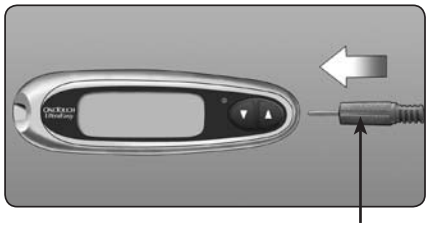

Câble d'interface

❶ Se procurer le câble et le logiciel requis
Pour obtenir des informations concernant la commande ou de plus amples renseignements sur le logiciel de suivi du diabète OneTouch®, consultez notre site Web à l'adresse suivante : www.OneTouch.be ou www.OneTouch.lu.

❷ Installer le logiciel sur un ordinateur
Suivre les instructions d'installation fournies avec le logiciel. Si un câble d'interface OneTouch® (format USB) est utilisé, installer le pilote logiciel.

⚠ MISE EN GARDE : pour éviter tout choc électrique, NE JAMAIS insérer de bandelette réactive pendant que le lecteur de glycémie est connecté à un ordinateur par l'intermédiaire du câble d'interface OneTouch®.

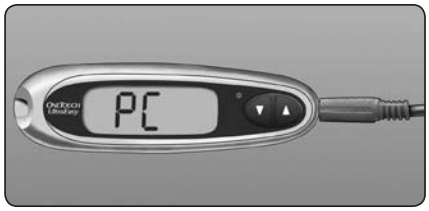

❸ Préparer le transfert des résultats
Connecter le câble d'interface OneTouch® au port COM ou USB de l'ordinateur. Vérifier que le lecteur est éteint. Si le câble est inséré alors que le lecteur est en marche, celui-ci ne répondra pas aux commandes de l'ordinateur. Connecter ensuite l'autre extrémité du câble d'interface OneTouch® au port de connexion du lecteur de glycémie.

❹ Transférer les données
Pour télécharger vos résultats à partir du lecteur, suivez les instructions fournies avec le logiciel de suivi du diabète OneTouch®. Une fois que l'ordinateur a envoyé au lecteur de glycémie la demande d'initialisation du téléchargement, le lecteur affiche « PC » à l'écran pour indiquer qu'il est en mode de communication. Il n'est pas possible d'effectuer un test de glycémie pendant que le lecteur est en mode de communication.

5 Réaliser un test avec la solution de contrôle

Quand effectuer un test avec la solution de contrôle

La solution de contrôle OneTouch® Ultra® contient une quantité déterminée de glucose ; elle permet de vérifier que le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement.

Effectuez un test avec la solution de contrôle :
- pour vous exercer à la procédure de test sans utiliser de sang ;
- une fois par semaine ;
- lorsque vous entamez un nouveau flacon de bandelettes réactives ;
- si vous suspectez un dysfonctionnement du lecteur ou des bandelettes réactives ;
- si vous obtenez des résultats de mesure de la glycémie inattendus répétés (comme décrits dans *Application du sang et lecture du résultat* au paragraphe 3), ou
- si vous faites tomber ou endommagez le lecteur.

REMARQUE :
- Seule la solution de contrôle OneTouch® Ultra® doit être utilisée avec le lecteur de glycémie OneTouch® UltraEasy®.
- Les tests effectués avec la solution de contrôle doivent être exécutés à température ambiante (entre 20 et 25 °C). Vérifier que le lecteur, les bandelettes réactives et la solution de contrôle sont à température ambiante avant d'effectuer un test.

⚠ **ATTENTION : ne pas** ingérer la solution de contrôle ; elle n'est pas destinée à la consommation humaine. **Ne pas** appliquer la solution de contrôle sur la peau ou les yeux pour ne pas provoquer une irritation.

Comment effectuer un test avec la solution de contrôle

Commencer avec le lecteur de glycémie éteint. Si le lecteur a déjà été mis en marche pour modifier des réglages ou consulter des résultats antérieurs, il faut l'éteindre.

❶ Vérifier le code imprimé sur le flacon de bandelettes réactives avant d'insérer la bandelette réactive

❷ Insérer une bandelette réactive pour mettre le lecteur de glycémie en marche
Les trois barres de contact doivent être orientées vers vous. Pousser la bandelette réactive dans la fente d'insertion jusqu'en bout de course. **Ne pliez pas** la bandelette.



❸ Faire correspondre le code affiché à l'écran du lecteur de glycémie avec celui imprimé sur le flacon de bandelettes réactives
Si le code du lecteur ne correspond pas au code du flacon de bandelettes réactives, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour le faire correspondre au numéro de code du flacon de bandelettes réactives. Le nouveau numéro de code clignote à l'écran durant trois secondes puis reste fixe durant trois autres secondes. L'affichage passe automatiquement à l'écran contenant l'icône d'application d'échantillon.

Si les codes correspondent, attendez trois secondes. L'affichage passe automatiquement à l'écran contenant l'icône d'application d'échantillon.

(Exemple)

❹ Indiquer qu'il s'agit d'un test avec solution de contrôle

IMPORTANT :
- Marquez les tests effectués avec la solution de contrôle, à l'aide du symbole **CtL**. Cela empêchera que ces résultats soient enregistrés comme des résultats de glycémie.
- Les résultats de test avec la solution de contrôle ainsi marqués par le symbole **CtL** ne sont pas enregistrés dans la mémoire du lecteur.

Appuyez sur ▲ pour que le symbole **CtL** de test avec la solution de contrôle apparaisse dans l'angle supérieur droit de l'écran. Le test doit être identifié avant l'application de la solution de contrôle. Une fois le test terminé, l'identification ne peut plus être modifiée. Le lecteur de glycémie est alors prêt pour réaliser un test avec solution de contrôle. Si l'utilisateur décide de ne pas effectuer de test avec la solution de contrôle, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche ▲ pour effacer le signe **CtL** de l'écran.

❺ Préparer et appliquer la solution de contrôle

Agitez le flacon de solution de contrôle avant chaque test. Enlever le capuchon et appuyer sur le flacon pour éliminer la première goutte. Essuyer ensuite l'embout à l'aide d'un tissu propre. Retourner le flacon et presser légèrement pour qu'une goutte se forme. Appliquer la goutte de solution de contrôle à l'extrémité supérieure de la bandelette réactive, au niveau du sillon étroit. Vérifier que la fenêtre de confirmation est complètement remplie. La solution de contrôle ne doit pas être appliquée sur la surface plane de la bandelette réactive.

❻ Lire le résultat

Lorsque la fenêtre de confirmation est remplie, le lecteur lance un compte à rebours de 5 à 1. Le résultat du test apparaît sur l'écran, ainsi que le symbole **CtL** et l'unité de mesure.

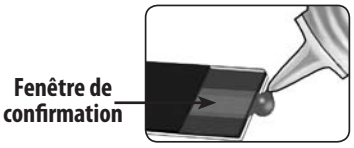

❼ Vérifier si le résultat se trouve dans l'échelle de valeurs correctes

Comparer le résultat affiché sur le lecteur de glycémie avec l'échelle de valeurs de la solution de contrôle imprimée **sur le flacon de bandelettes réactives.** L'échelle de valeurs de la solution de contrôle peut varier d'un flacon de bandelettes réactives à l'autre. Si les résultats obtenus ne se trouvent pas dans la plage indiquée, il est possible que le lecteur de glycémie et les bandelettes réactives ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, répéter le test avec la solution de contrôle.

Des résultats situés hors de l'échelle établie peuvent être causés par :

- le non-respect des instructions, détaillées aux étapes 1 à 7 ;
- une solution de contrôle périmée ou contaminée ;
- une bandelette réactive périmée ou endommagée ;
- l'utilisation d'une bandelette réactive ou de la solution de contrôle après sa date d'élimination ou
- un problème au niveau du lecteur de glycémie.

⚠ **ATTENTION :** les valeurs de solution de contrôle figurant sur le flacon de bandelettes réactives sont valables uniquement pour la solution de contrôle OneTouch® Ultra®. Il ne s'agit en aucun cas de valeurs recommandées pour le taux de glucose.

⚠ **ATTENTION :** si les résultats de test avec la solution de contrôle continuent de se situer en dehors de l'échelle de valeurs figurant sur le flacon de bandelettes réactives, **n'utilisez** ni le lecteur, ni les bandelettes, ni la solution de contrôle. Appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).

6 Entretien du système

Remplacement de la pile

Le lecteur OneTouch® UltraEasy® utilise une pile de 3,0 V au lithium modèle CR 2032 (ou équivalent). Ce type de pile est en vente dans la plupart des lieux proposant ce genre d'articles. Il est livré avec la pile préalablement installée. Une icône pile apparaît à l'extrême droite de l'écran du lecteur pour indiquer que la pile est faible.

Lorsque la charge de la pile est suffisante pour effectuer encore au moins 100 tests, l'icône pile apparaît.

Après chaque test et lorsque vous revoyez les résultats précédents, l'icône pile clignote pour vous rappeler de changer la pile dès que possible.

Lorsque l'icône pile clignote d'elle-même sur l'écran, **vous ne pouvez pas procéder au test**. Il faut alors remplacer la pile pour pouvoir réutiliser le lecteur.



Remplacement de la pile

❶ Enlever la pile usagée
Commencer avec le lecteur de glycémie éteint. Ôter le couvercle des piles et tirer sur le ruban de la pile à remplacer.

⚠ MISE EN GARDE : pour éviter tout choc électrique, ne jamais changer une pile pendant que le lecteur est connecté à un ordinateur via le câble d'interface OneTouch®.

❷ Insérer la nouvelle pile

En plaçant le signe « + » sur le dessus, insérer la nouvelle pile dans le compartiment, dans le pli du ruban. Enfoncez la pile jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée. Insérer les deux languettes des couvercles de piles dans les orifices prévus à cet effet et appuyer jusqu'à ce que le couvercle émette un déclic.

Si le lecteur ne se met pas en marche après le remplacement de la pile, vérifiez que la pile est bien insérée avec le signe « + » vers le haut. Si le lecteur persiste à ne pas se mettre en marche, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).

❸ Vérifier la date et l'heure

Après avoir remplacé la pile, mettez le lecteur en marche en appuyant sur ▼ et en maintenant la touche enfoncée durant cinq secondes pour accéder au mode Réglage. L'écran de démarrage s'affiche brièvement ; puis la date et l'heure s'affichent dans l'angle supérieur droit de l'écran. Vérifiez que la date et l'heure sont correctes. Si elles ne le sont pas, reprogrammez le lecteur à l'aide des boutons ▲ et ▼ avant d'effectuer un test. Voir *Réglage de la date et de l'heure* au paragraphe 2.

REMARQUE : le remplacement de la pile du lecteur de glycémie est sans effet sur les résultats mis en mémoire. Toutefois, il sera peut-être nécessaire de régler de nouveau la date et l'heure.

❹ Jeter les piles conformément à la réglementation locale de protection de l'environnement

Veuillez recycler ou jeter les piles usagées à l'aide des systèmes de collecte locaux, conformément aux lois et réglementations environnementales locales. Les piles contiennent des produits chimiques qui, s'ils sont relâchés dans le milieu ambiant, peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Le symbole de la poubelle à roulettes barrée d'une croix indique que la collecte des piles doit être distincte des déchets domestiques.

Entretien du système

Le système de surveillance de la glycémie OneTouch® UltraEasy® ne nécessite aucun entretien particulier.

Ranger le système
Rangez le lecteur, les bandelettes réactives et la solution de contrôle dans votre étui de transport après chaque utilisation. Conservez chaque élément dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 30 °C, mais **ne les placez pas** dans un réfrigérateur. Conserver tous les éléments à l'abri du soleil et de la chaleur. Bien refermer le flacon de bandelettes réactives et/ou le flacon de solution de contrôle après utilisation afin d'éviter toute contamination ou détérioration. Conserver les bandelettes réactives dans leur flacon d'origine uniquement.

Contrôler l'état ou la date de péremption des bandelettes réactives et de la solution de contrôle
Une date de péremption est imprimée sur les flacons de bandelettes réactives et de solution de contrôle. Lorsque vous ouvrez un flacon de bandelettes réactives ou de solution de contrôle pour la première fois, vous devez noter la date de péremption sur l'espace de l'étiquette prévu à cet effet.

- **Bandelettes réactives :** date d'ouverture plus six **(6)** mois
- **Solution de contrôle :** date d'ouverture plus trois **(3)** mois

⚠ **ATTENTION : n'utilisez pas** les bandelettes réactives ou la solution de contrôle après la date de péremption imprimée sur le flacon ou après la date d'élimination que vous avez calculée lors de la première ouverture du flacon, suivant celle qui est atteinte en premier, sous peine d'obtenir des résultats erronés.

⚠ **ATTENTION : n'utilisez pas** de bandelettes réactives provenant d'un flacon endommagé ou laissé ouvert. Il pourrait en résulter des messages d'erreur ou des tests donnant des résultats plus élevés que la réalité. Appelez immédiatement le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg) si le flacon de bandelettes réactives est endommagé.

Nettoyer le lecteur de glycémie
Pour nettoyer l'extérieur du lecteur, l'essuyer à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux. **N'utilisez pas** d'alcool ou d'autre solvant pour nettoyer le lecteur.

Évitez toute pénétration de liquide, saleté, poussière, sang ou solution de contrôle à l'intérieur du lecteur, par le port de connexion ou la fente d'insertion. Ne jamais vaporiser de produit nettoyant sur le lecteur de glycémie ; ne jamais l'immerger dans un liquide.

Nettoyer le stylo autopiqueur et l'embout transparent
Pour nettoyer ces éléments, essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux. **N'immergez pas** le stylo autopiqueur dans un liquide.

Pour désinfecter ces composants, préparez une solution d'eau de javel diluée à 10 %. Essuyer le stylo autopiqueur avec un chiffon doux imbibé de cette solution. Immergez **uniquement les embouts** dans cette solution pendant 30 minutes. Après la désinfection, rincer brièvement à l'eau et laisser sécher à l'air libre.

7 Messages d'erreur et informations détaillées sur votre lecteur

Comprendre les messages d'erreur et les autres messages

Le lecteur de glycémie OneTouch® UltraEasy® affiche des messages en cas de problème avec la bandelette réactive ou le lecteur, ou lorsque le taux de glucose est supérieur à 600 mg/dL ou inférieur à 20 mg/dL. Si un problème survient au cours d'un test, un message d'erreur n'apparaîtra pas nécessairement. Toute utilisation incorrecte peut entraîner un résultat erroné sans pour autant afficher un message d'erreur.

Message	Signification	Intervention
	Votre taux de glucose est très bas (hypoglycémie sévère), inférieur à 20 mg/dL.	**Dans ce cas, traitez immédiatement en suivant les recommandations du médecin traitant.** Même si ce message peut être dû à une erreur de test, il est plus sûr de traiter d'abord, puis de renouveler le test.
	Votre taux de glucose est très élevé (hyperglycémie sévère), supérieur à 600 mg/dL.	Contrôlez de nouveau votre taux de glycémie. Si le lecteur affiche de nouveau HI, contacter immédiatement le médecin traitant et suivre ses instructions.
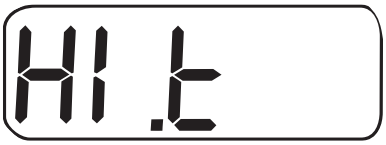	Le lecteur a détecté que la température ambiante est trop élevée pour un fonctionnement normal du système. **Ne réalisez pas** de test avant que la température du lecteur et des bandelettes réactives n'ait atteint la plage de fonctionnement de 6 à 44 °C.	Répétez le test dès que le lecteur et les bandelettes réactives ont atteint une température comprise dans la plage de température de fonctionnement.
	Le lecteur a détecté que la température ambiante est trop basse pour un fonctionnement normal du système. **N'effectuez pas** de test tant que le lecteur et les bandelettes n'ont pas atteint une température située entre 6 et 44 °C.	Répétez le test dès que le lecteur et les bandelettes réactives ont atteint une température comprise dans la plage de température de fonctionnement.

Message	Signification	Intervention
	Aucun résultat n'est enregistré en mémoire, comme c'est le cas lors de la première utilisation du lecteur de glycémie. *ou*, Votre lecteur n'est pas en mesure de rappeler ce résultat.	Un test de glycémie peut encore être effectué et fournir un résultat exact. Contactez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg) pour le signaler si ce **n'est pas** votre première utilisation du lecteur.
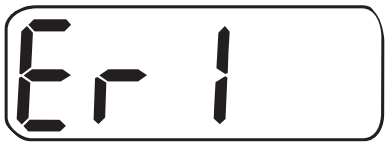	Un message d'erreur indique un problème de lecteur.	**N'utilisez pas** le lecteur. Contactez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).
	Message d'erreur dû à l'utilisation d'une bandelette réactive usagée ou à un problème de lecteur de glycémie.	Répétez le test avec une bandelette réactive neuve ; consultez le paragraphe 3, Test de glycémie. Si ce message d'erreur se représente, contactez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).
	Message d'erreur indiquant que l'échantillon de sang ou de solution de contrôle a été déposé avant que le lecteur ne soit prêt.	Répétez le test avec une bandelette réactive neuve. Déposez l'échantillon sanguin ou la solution de contrôle seulement après l'apparition de l'icône clignotante d'application d'échantillon à l'écran. Si ce message d'erreur se représente, contactez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg)

Message	Signification	Intervention
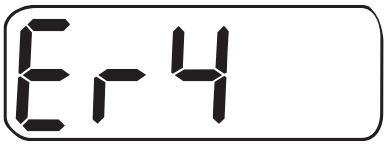	***L'une des situations suivantes se produit :*** Votre glycémie est peut-être élevée et vous effectuez un test à une température ambiante proche de la limite inférieure de la plage de températures de fonctionnement du système (6 à 44 °C). *ou*,	Si le test a été effectué à une température ambiante peu élevée, le refaire avec une nouvelle bandelette réactive dans un environnement plus tempéré ; consultez le paragraphe 3, Test de glycémie. Si ce message d'erreur se représente, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).
	Le problème peut provenir de la bandelette réactive. Par exemple, la bandelette peut avoir été endommagée ou déplacée au cours du test. *ou*,	Si vous avez effectué le test à température ambiante normale ou élevée, répétez-le avec une nouvelle bandelette réactive ; consultez le paragraphe 3, Test de glycémie. Si ce message d'erreur se représente, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).
	L'échantillon sanguin n'a pas été appliqué correctement. *ou*,	Si vous avez appliqué l'échantillon sanguin de manière incorrecte, revoyez les modalités d'application de l'échantillon sanguin (voir paragraphe 3, Test de glycémie) ou de réalisation d'un test avec la solution de contrôle (voir paragraphe 5, Test avec solution de contrôle) et répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive. Si ce message d'erreur se représente, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).
	Il y a peut-être un problème de lecteur.	Si ce message d'erreur se représente, appelez le Service OneTouch® au 0800/14660 (Belgique) ou 800-25749 (Luxembourg).
	Le lecteur a détecté un problème de bandelette. Les causes possibles sont : bandelette réactive endommagée ou fenêtre de confirmation insuffisamment remplie.	Répétez le test avec une bandelette réactive neuve. Reportez-vous aux informations relatives à l'application de l'échantillon sanguin (voir paragraphe 3, Test de glycémie) ou au test avec la solution de contrôle (voir paragraphe 5, Test avec solution de contrôle).
	La pile du lecteur est faible, mais sa charge est suffisante pour effectuer un test de glycémie.	Lorsque l'icône de la pile apparaît pour la première fois, la pile du lecteur a une charge suffisante pour effectuer au moins 100 tests. Les résultats de test sont toujours exacts, mais la pile doit être remplacée au plus tôt.
	L' icône clignote d'elle-même sur l'écran lorsque la charge de la pile est insuffisante pour effectuer un test ou pour afficher les résultats antérieurs.	Remplacez la pile du lecteur.

Informations détaillées sur le système

Comparaison des résultats du lecteur avec ceux d'un laboratoire

Les résultats de tests réalisés avec le lecteur OneTouch® UltraEasy® sont étalonnés sur plasma pour faciliter la comparaison des résultats avec ceux obtenus en laboratoire. L'utilisation antérieure d'un autre type de lecteur, donnant des résultats étalonnés sur sang total, permet à l'utilisateur de constater que les résultats de test obtenus avec le lecteur OneTouch® UltraEasy® sont supérieurs d'environ 12 %.

Les résultats des tests du lecteur OneTouch® UltraEasy® et les résultats des tests de laboratoire sont exprimés en unités équivalent-plasma. Néanmoins, les résultats obtenus par le lecteur peuvent différer des tests de laboratoire, en raison de variations considérées comme normales. Les résultats du lecteur peuvent être affectés par des facteurs et des conditions qui ne s'appliquent pas de la même façon lors des tests réalisés en laboratoire.

Les taux de glucose déterminés par le lecteur OneTouch® UltraEasy® sont considérés comme exacts lorsqu'ils se situent à ±20 % des résultats de laboratoire. Certaines situations particulières peuvent entraîner une différence supérieure à ±20 % :

- Vous avez pris un repas récemment. La glycémie réalisée au bout du doigt peut être supérieure de 70 mg/dL à celle d'un prélèvement de sang veineux, pratiquée en laboratoire[1].
- Votre hématocrite (pourcentage de globules rouges dans le sang) est élevé (supérieur à 55 %) ou faible (inférieur à 30 %).
- Vous souffrez d'une déshydratation sévère.
- Un test a été effectué à une température proche de la limite inférieure de la plage de fonctionnement (6 °C) et a indiqué un taux de glucose élevé (supérieur à 180 mg/dL). Dans ce cas, renouvelez le test dans un endroit plus chaud avec une nouvelle bandelette réactive aussi rapidement que possible.

La notice contenue dans l'emballage des bandelettes réactives fournit des précisions importantes sur les limites, la précision et l'exactitude des informations de test. Afin d'optimiser les conditions d'une comparaison précise entre résultats du lecteur et résultats de laboratoire, les directives suivantes doivent être observées.

Avant de vous rendre au laboratoire

- Effectuez un test avec la solution de contrôle pour vous assurer que le lecteur fonctionne correctement.
- **Ne mangez pas** pendant les huit heures qui précèdent votre test sanguin.
- Se rendre au laboratoire avec le lecteur de glycémie.

Une fois au laboratoire

- Faites un test avec votre lecteur à un écart de 15 minutes du test de laboratoire.
- Utiliser uniquement du sang capillaire frais prélevé au bout du doigt.
- Respectez toutes les instructions contenues dans le présent guide d'utilisation pour exécuter le test de glycémie avec votre lecteur.

1. Sacks, D.B.: "Carbohydrates." Burtis, C.A., and Ashwood, E.R. (ed.), *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*. Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959.

Caractéristiques techniques

Plage de résultats couverte	20-600 mg/dL
Calibration	sur plasma
Échantillon	sang total capillaire frais
Durée du test	5 secondes
Méthode d'analyse	biocapteur de glucose oxydase
Source d'alimentation du lecteur	une pile au lithium de 3,0 V modèle CR 2032 (ou équivalent) remplaçable
Unités de mesure	mg/dL
Mémoire	500 résultats de test de glycémie
Arrêt automatique	2 minutes après la dernière intervention
Taille	10,8 x 3,20 x 1,70 cm
Poids	environ 40 grammes, pile comprise
Conditions de fonctionnement	Température : 6–44°C Altitude : jusqu'à 3048 mètres Humidité relative : 10–90% Taux d'hématocrite : 30–55%
Valeurs nominales des piles	une pile 3,0 V CC, 3 mA (une pile CR 2032) ⎓ courant continu

Symboles

⚠ Avertissements et mises en garde : reportez-vous aux remarques relatives à la sécurité dans le présent guide d'utilisation et dans les notices fournies avec le lecteur et les éléments nécessaires au test.

⎓	Courant continu		Pile faible
SN	Numéro de série	LOT	Numéro de lot
	Fabricant		Date de péremption
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro		Limites de température de conservation
STERILE R	Stérilisé par irradiation	Σ <n>	Contient un volume suffisant pour <n> tests
	Consulter le manuel d'utilisation		
	Ne pas réutiliser		
	Collecte séparée des piles		

Les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie de LifeScan sont conformes aux directives UE suivantes :

IVDD (98/79/EC) :

CE 0344 Lecteur de glycémie, bandelettes réactives et solution de contrôle.

MDD (93/42/EEC) :

CE 0120 Lancettes

CE Stylo autopiqueur

LifeScan Europe
Division of Cilag GmbH
International
6300 Zug
Switzerland

Normes relatives à l'électricité et à la sécurité
L'immunité du lecteur à une décharge électrostatique de niveau 4 telle que définie dans CEI 61000-4-2 a été testée. L'immunité de ce lecteur aux interférences de radiofréquence sur la plage de fréquences 80 MHz–2,5 GHz à 3 V/m tel que défini dans CEI 61000-4-3 a été testée. Indice du degré de protection : minimum de IP2X. Ce lecteur est conforme à la norme CISPR 11:2003, Classe B (émissions rayonnées uniquement) Les émissions issues de l'énergie utilisée sont faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques se trouvant à proximité.

Garantie
LifeScan garantit le lecteur OneTouch® UltraEasy® contre tout vice de forme et de fabrication pour une durée de trois ans à compter de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Le système décrit ici est protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5.708.247, 5.951.836, 6.241.862, 6.284.125, 7.112.265 et D546 216. L'utilisation du dispositif d'autosurveillance inclus est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 6.413.410, 6.733.655, 7.250.105, 7.468.125. L'achat de ce dispositif n'octroie pas de licence pour ces brevets. Une telle licence n'est octroyée que dans le cadre de l'utilisation du dispositif avec les bandelettes réactives OneTouch® Ultra®. Aucun fournisseur de bandelettes réactives autre que LifeScan n'est autorisé à accorder une telle licence. La précision des résultats générés par les lecteurs LifeScan à l'aide de bandelettes réactives d'un autre fabricant n'a pas été contrôlée par LifeScan.

Remarques